



Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

TT-52 DX

GENERADOR DE RAYOS X DENTALES
PORTÁTIL DE ULTRAALTA FRECUENCIA



DOSIS DE RADIACIÓN ULTRABAJA


La pared interior del cilindro largo y la carcasa exterior de la máquina están recubiertas con gruesas capas de plomo para reducir la radiación y proteger la salud de los operadores y veterinarios.

EXPOSICIÓN DISPONIBLE MEDIANTE CONTROL REMOTO

La máquina de rayos X se encuentra cerca del animal y el operador se encuentra lejos del entorno de exposición. La exposición se realiza mediante control remoto.

IMÁGENES NÍTIDAS CON UN PUNTO FOCAL DE 0,04 MM.

Independientemente del sensor intraoral que utilicemos, TT-52 DX minimiza el desenfoque y proporciona un valor diagnóstico adicional con un punto focal de 0,04 mm.

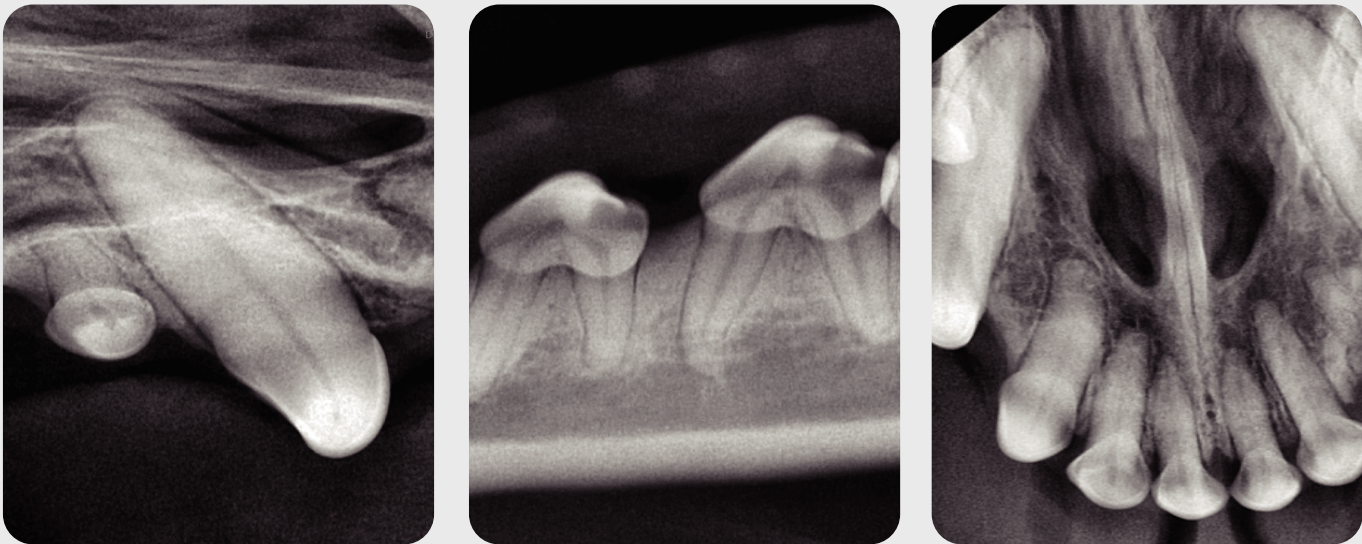

OPERACIÓN SENCILLA CON PANTALLA TÁCTIL

El panel de control ubicado en el cabezal del tubo simplifica y agiliza el flujo de trabajo. Todos los ajustes se encuentran en la pantalla táctil. Simplemente seleccione lo que necesite.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Pistola
PANTALLA	Pantalla táctil LCD
PRESIÓN DEL TUBO	60KV/65KV/70KV (adjustable en 3 niveles)
CORRIENTE DEL TUBO	2,5mA/3,5mA (adjustable en 2 niveles)
ENFOQUE DEL TUBO	0.4 mm
DISTANCIA ENFOQUE-PIEL	200 mm
TIEMPO DE EXPOSICIÓN	0.01 - 1.0 s
FRECUENCIA DE ONDULACIÓN	<1.0%
FRECUENCIA DE INVERSIÓN	>100KHZ
POTENCIA DE ENTRADA	100-240V AC, 50/60HZ
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	DC 22,2V/950mAh
DOSIS DE RADIACIÓN	2.447 mGy
DOSIS DE RADIACIÓN POR FUGA SUERFICIAL	0.0007 mSv
PESO NETO	2 kg
PESO BRUTO	4 kg
TAMAÑO DE LA CAJA	34 x 34 x 15